MANUEL D'UTILISATION DU VAPORISATEUR

PUFFIT™

UTILISATION

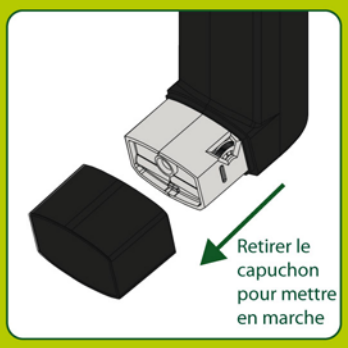

Replacez toujours le capuchon de l'embout buccal après utilisation.

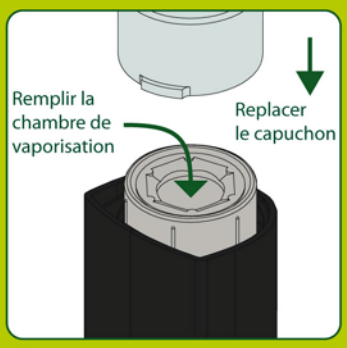

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez uniquement un mélange sec finement broyé et bien tassé.

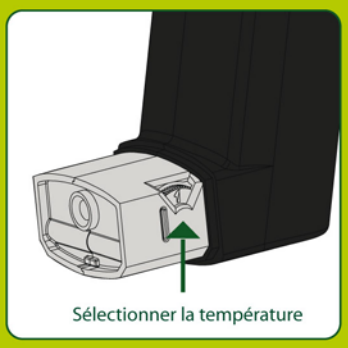

Si vous n'êtes pas sûr de la température de vaporisation de votre mélange, démarrez à basse température.

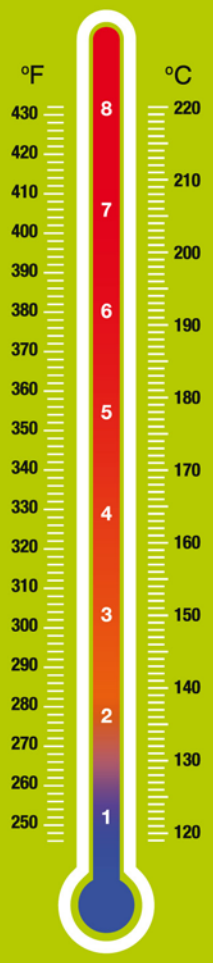

Veillez à ce que l'environnement de la chambre de vaporisation soit propre et exempt de résidus.

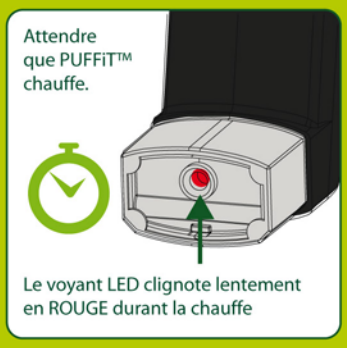

Lorsque le voyant LED passe au VERT, votre PUFFiTTM a atteint la température désirée.

De longues bouffées garantissent une meilleure saveur. Ne pas inhaler ! PUFFiTTM se remet en veille au bout de 15 secondes.

CYCLE DU VOYANT LED

TÉMOIN LUMINEUX ROUGE

MODO DE ESPERA

Votre PUFFiT™ se mettra automatiquement en veille au bout de 90 secondes. Pour redémarrer, remettre le capuchon et l'enlever aussitôt

CLIGNOTEMENT LENT ROUGE

EN TRAIN DE CHAUFFER

Durée : 10-30 s, selon le mélange et la température choisie.

TÉMOIN LUMINEUX VERT

TEMPÉRATURE ATTEINTE

Savourez la saveur et l'arôme de votre vapeur

TÉMOIN LUMINEUX ORANGE

RÉINITIALISATION

Cette phase évite la surchauffe de votre PUFFiTTM et augmente la durée de vie de la batterie

SIGNAL DE PANNE LED

CLIGNOTEMENT RAPIDE ROUGE/ VERT

BLOCAGE DE L'INTERRUPTEUR DU COUVERCLE DU RÉSERVOIR À HERBE

Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus bloqués sous le capuchon. Il doit pouvoir pivoter librement et produire un léger clic quand il est enclenché.

CLIGNOTEMENT RAPIDE ROUGE

BATTERIE FAIBLE

Branchez votre PUFFiTTM à une source USB pour le recharger.

CLIGNOTEMENT RAPIDE ORANGE

ERREUR

Veuillez contacter le service clientèle.

CHARGE

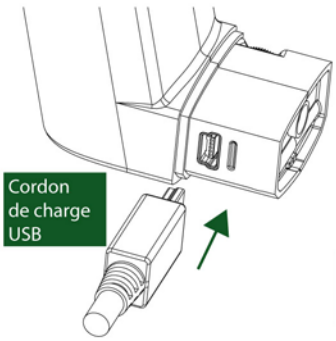

Pour recharger votre PUFFiT™, il suffit de le brancher à une source USSE standard. Le voyant LED clignote alors lentement en vert durant la charge et s'éteint une fois celle-ci achevée.

branchez votre PUFFiT™ dès que vous ne l'utilisez pas. Cela augmentera la durée de vie de la batterie.

Après avoir chargé votre PUFFiT™, le dispositif rentrera dans le mode d'alimentation faible. Pour le réintialiser, remplacer le capuchon magnétique pendant 2 sécondes.

Pour obtenir une indication approximative du niveau de charge, cliquer sur le capuchon en aluminium 3 fois. Le DEL s'éteindra pendant une seconde et ensuite indiquera le niveau approximatif du charge. ~ 80% ~ 60% < 30%.

Visiter:

NOZA DISTRIBUTION

discreet vape

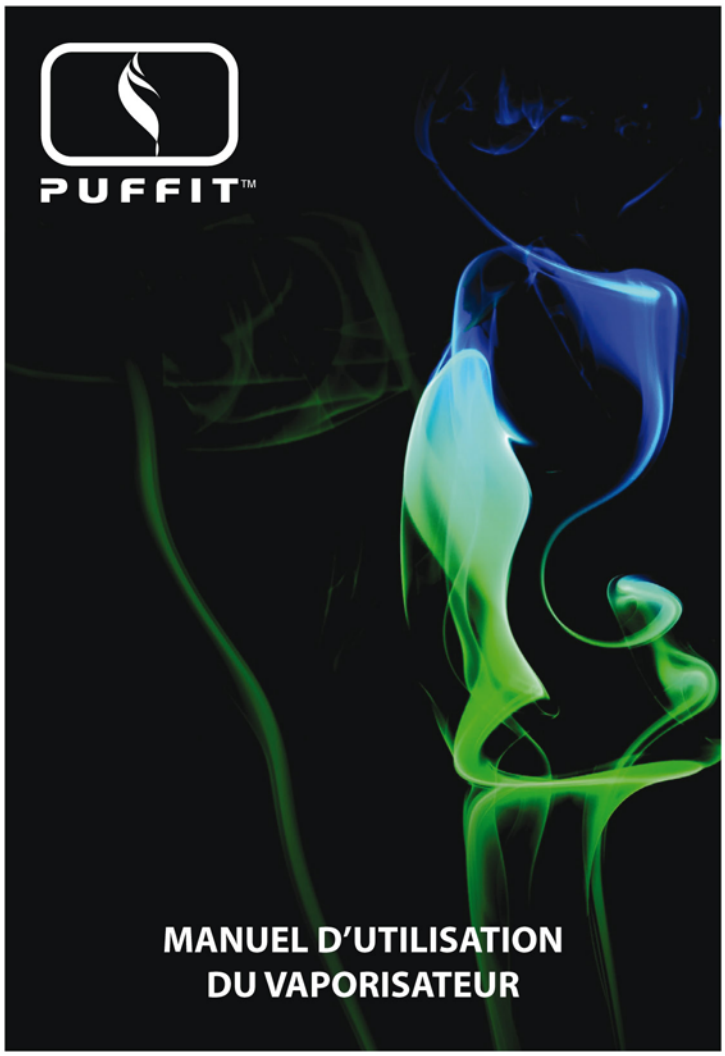

AVERTISSEMENTS

- Cet objet dégage de la chaleur ! Manipulez-le avec précaution et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas mettre en marche PUFFiT™ si la chambre de vaporisation est vide !
- Ne pas mettre en marche PUFFiT™ si le capuchon de la chambre de vaporisation n'est pas en place !
- Toujours laisser refroidir PUFFiT™ avant de le ranger !
- Ne pas utiliser de liquides, de gels ou de concentrés avec PUFFiT™.
- Ne pas nettoyer avec des objets durs ou tranchants !
- Recharger PUFFiT™ uniquement avec le cordon USB d'origine (5V 500mA CC)
- Ne pas immerger ni nettoyer PUFFiT™ à l'eau courante !
- Ne pas laisser PUFFiT™ allumé pendant une période prolongée (sans capuchon de l'embout buccal). Cela peut endommager la batterie et rendre la garantie caduque. Toujours replacer le capuchon de l'embout après utilisation !

GARANTIE

Votre PUFFiT™ est couvert par une garantie de remplacement limitée contre les vices de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Les clients sont priés d'enregistrer leur achat d'un PUFFiT™ auprès de Lilly Rucky Ltd ; v. coordonnées indiquées ci-dessous. Pour un échange sous garantie, veuillez retourner votre PUFFiT™ au point de vente. Lilly Rucky Ltd. se réserve le droit de déterminer la validité de toute réclamation soumise au titre de la garantie.

Contenu du pack Vaporisateur PUFFiT™

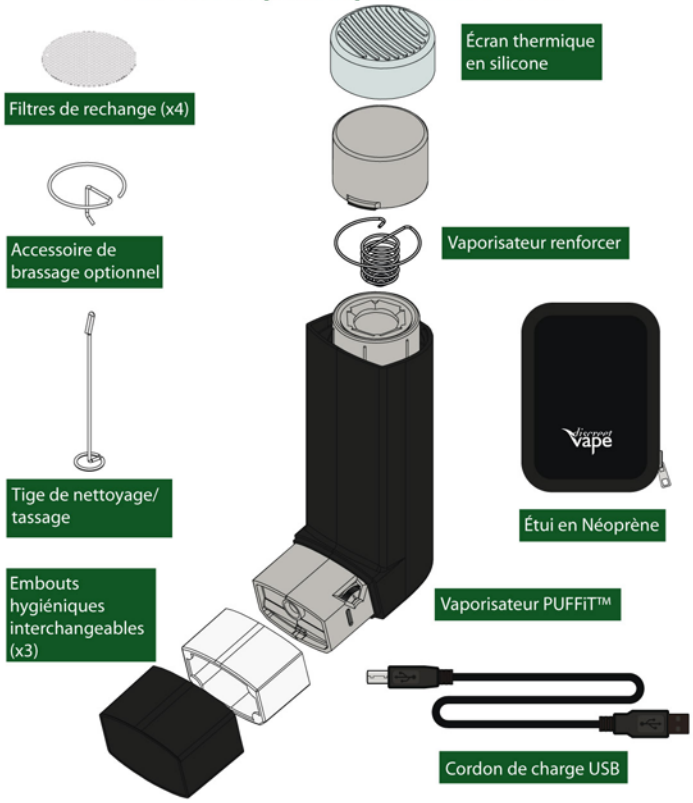

CONDITIONS D'UTILISATION

PUFFiT™ n'est pas un appareil médical ; Lilly Rucky Ltd. décline toute responsabilité quant à la valeur thérapeutique de son utilisation. Lilly Rucky Ltd. ne saurait notamment être tenu pour responsable en cas de dommage personnel ou matériel résultant d'une utilisation inappropriée ou illégale de cet appareil ; nous ne pouvons pas non plus recommander son utilisation avec d'autres substances que des herbes et fleurs séchées inoffensives.

INFORMATIONS

Noza distribution
8, rue Jean Moulin
62 000 Dainville
France

Tel : 03 21 60 00 01
Email : info@nozadis.com

www.nozadis.com

ATTENTION !

PUFFiT™ n'est pas un appareil médical !
Il n'est pas destiné au diagnostic, au traitement, aux soins ou à la prévention des douleurs, maladies ou autres états de santé. Si vous avez des problèmes de santé, veuillez consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation. PUFFiT™ n'est pas destiné à la prise de produits médicinaux, autorisés ou illégaux, ni à être utilisé avec une substance susceptible d'affecter la structure ou les fonctions corporelles.

www.discreetvape.com

Copyright © 2012 Lilly Rucky Ltd. Tous droits réservés .